



vivo Surgical

ILLUMINAZIONE CHIRURGICA IN VIVO ISTRUZIONI PER L'USO



PRODUTTORE

Vivo Surgical Private Limited
1090 Lower Delta Road #06-11/16
Singapore 169201
Singapore
T: (+65) 6272 6898
E: support@vivo-surgical.com

EC REP

RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO

Medical Technology Promedt
Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
66386 St. Ingbert, Germania

Contenuto della confezione: 5 KLAROTM	REF 555-01-01	LOT YYMMXX		
				YYYY-MM
IPX4	15°C 30°C	40% 70%	STERILE EO	

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KLAROTM è un dispositivo di illuminazione chirurgico per cavità profonde a LED per uso chirurgico aperto. È discreto, facile da usare e fornisce un "illuminazione piena" brillante, uniforme e localizzata dell'interno dell'area chirurgica. KLAROTM mantiene una temperatura di lavoro fredda e sicura, adatta per l'uso all'interno del corpo umano, indipendentemente dall'intensità luminosa selezionata.

Caratteristiche principali

- Sterile, monouso gettabile
- Fatto di forma discreta in un piccolo dispositivo alimentato a batteria
- Mantiene una temperatura di lavoro sicura. (<38 °C) per tutta la durata di vita di 4 ore
- Illuminazione ampia e variabile ad angolo "pieno" (oltre 180°)
- Intensità luminosa regolabile
- Autoportante - l'utente non deve reggere il dispositivo durante l'intervento chirurgico

Indicazioni per l'uso

L'illuminazione chirurgica KLAROTM In Vivo Surgical Lighting ha lo scopo di fornire un'illuminazione localizzata e diretta " illuminazione piena " dell'area chirurgica aperta.

Avvertenze e precauzioni

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Sterilizzazione e Smaltimento:

- KLAROTM è stato sterilizzato nella sua confezione con Ossido di Etilene (OE) ed è un prodotto monouso.
- Non riutilizzare o risterilizzare KLAROTM.
- Dopo l'uso, smaltire KLAROTM secondo le norme nazionali sullo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.

Uso e sicurezza del prodotto:

- Non utilizzare per scopi diversi dallo scopo predestinato. Non porre il prodotto a contatto diretto con il cuore, il sistema circolatorio centrale o il sistema nervoso centrale.
- Prima di aprire la confezione contenente KLAROTM, controllare che la confezione non presenti perforazioni, strappi o il sigillo non integro. Non utilizzare il prodotto se la confezione è stata danneggiata o aperta.
- Maneggiare il prodotto con cura. Non far cadere o lanciare il dispositivo. Non usare una forza eccessiva quando si utilizza KLAROTM in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Se danneggiato, non continuare ad utilizzare il prodotto. Sostituirlo con un KLAROTM nuovo.

- Non dirigere la luce direttamente negli occhi.
- Non lasciare KLAROTM vicino a strumenti conduttori o a contatto con dispositivi di energia attiva, in quanto potrebbero danneggiare KLAROTM e renderlo inutilizzabile.
- KLAROTM contiene una batteria al biossido di manganese e al litio non ricaricabile. Non ricaricare, smontare, riscaldare oltre i 100 °C, incenerire o esporre la batteria direttamente in contatto con acqua. Non immergere il pacco batteria in un liquido, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- KLAROTM è stato testato ed è conforme alle norme di sicurezza elettrica e alle norme EMC secondo EN 60601-1:2006+A1:2013+A11:2011+A12:2014 e IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, EN 60601-1-2:2015 e IEC 60601-1-2:2014.

- KLAROTM può essere utilizzato per un massimo di 4 ore consecutive. Quando KLAROTM raggiunge le 3 ore e 45 minuti di utilizzo, un LED rosso si accenderà accanto alla Linea di Delimitazione Nera sulla punta della luce che indica i 15 minuti rimanenti di utilizzo.
- KLAROTM deve essere utilizzato in abbattimento con gli apparecchi chirurgici esistenti in sala operatoria.


Conservazione:

- KLAROTM deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto con temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 30 °C e tra il 40 e il 70% di umidità relativa.
- Non utilizzare KLAROTM al di là della data di scadenza indicata sulla confezione.

Guida per l'utente

Le seguenti indicazioni valgono come istruzioni per l'utente per ottenere la migliore efficienza nell'uso di KLAROTM:

- Aprire la confezione e posizionare KLAROTM sul campo sterile.
- Togliere il Copertura Protettiva. Ispezionare il prodotto per verificare l'eventuale presenza di danni. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.

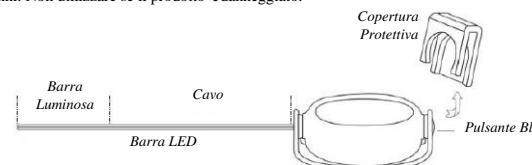

3. Fissare il pacco batteria sul telo chirurgico utilizzando la molletta integrata.



Nota: La molletta può essere riposizionata in qualsiasi area desiderata del telo chirurgico per tutta la durata dell'intervento (Numero massimo di riposizionamenti: 100 volte).

- Tenere la barra luminosa e premere il pulsante blu con il simbolo sul pacco batteria UNA VOLTA per attivare la barra luminosa fino all'impostazione "BASSA Intensità".
- I LED luminosi si trovano sulla parte FRONTALE della barra luminosa. La barra luminosa può essere piegata dalla parte FRONTALE alla POSTERIORE e viceversa in senso inverso.




Nota:

- Durante l'utilizzazione di KLAROTM, la barra luminosa può essere piegata con varie angolazioni a seconda delle esigenze dell'utente al momento dell'intervento.

- Si raccomanda all'utente di piegare la barra luminosa tra la Linea di Delimitazione Nera e la punta della barra luminosa.

- Si consiglia di piegare la barra luminosa nello stesso punto per più di 10 volte.
- Una volta che la barra luminosa è stata piegata all'angolo desiderato, posizionarla all'interno della cavità dell'incisione chirurgica. Fissare il pacco batteria sui telo chirurgici.



7. L'intensità della luce può essere regolata in qualsiasi punto durante l'intervento chirurgico premendo il pulsante blu con il simbolo come segue:



Nota: Durante l'intervento, i fluidi corporali o dei residui possono rimanere attaccati alla barra luminosa e influire sull'intensità della luce emessa. L'utente può usare una spugnetta, una salvietta o una garza con acqua sterilizzata per pulire la superficie della barra luminosa.

8. Al termine dell'intervento chirurgico, se richiesto dalle normative nazionali sullo smaltimento delle batterie agli ioni di litio, scaricare la batteria prima di smaltire KLAROTM. In caso contrario, smaltire direttamente KLAROTM secondo le normative nazionali sullo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.

Anello Retrattore

KLAROTM è dotato di 4 Anelli Retrattori (AR). Gli ARs consentono all'utente di fissare facilmente e rapidamente la Barra LED KLAROTM sulla maggior parte dei retrattori chirurgici presenti sul mercato. Le seguenti indicazioni servono all'utente per avere un'utilizzazione ottimale nell'uso di KLAROTM in combinazione con gli ARs:

- Inserire la lama del retrattore chirurgico attraverso l'anello ② dell'AR.
- Posizionare il primo AR lungo la lama del retrattore (ad es. nella posizione ④ illustrata).
- Per una maggiore stabilità utilizzare un secondo AR (ad es. nella posizione ⑤ illustrata).
- Una volta che gli ARs sono in posizione sul retrattore, inserire la Barra LED KLAROTM nell'anello passante ① dell'AR come mostrato.
- La Barra LED KLAROTM può essere piegata dall'utente in modo che si adatti alla forma della lama del retrattore per fornire una stabilità ottimale durante la procedura.
- Al termine della procedura chirurgica, smaltire gli ARs seguendo le stesse istruzioni di smaltimento di KLAROTM.

Nota:

- Gli ARs sono forniti sterili nella stessa confezione di KLAROTM.
- Gli ARs sono monouso gettabili. Non riutilizzarle o risterilizzarle.
- Non usare una forza eccessiva quando si usano gli ARs.



Note EMC

- L'acquirente o l'utilizzatore di KLAROTM deve utilizzare il dispositivo in un ambiente elettromagnetico specifico. In caso contrario, ciò potrebbe causare il malfunzionamento di KLAROTM.
- Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili possono influire sul normale utilizzo di KLAROTM. Si raccomanda di utilizzare KLAROTM nell'ambiente elettromagnetico consigliato.
- Le EMISSIONI caratteristiche di questa apparecchiatura la rendono adatta all'uso in aree industriali e ospedalieri (CISPR 11 classe A). Se viene utilizzato in un ambiente residenziale (per il quale è normalmente richiesto il CISPR 11 classe B) questa apparecchiatura potrebbe non offrire una protezione adeguata ai servizi di comunicazione a radiofrequenza. L'utente potrebbe dover adottare misure di attenuazione, come il riposizionamento o il riorientamento dell'apparecchiatura.

EMC Avvertenza

- L'uso di questa apparecchiatura adiacente o impilata con altre apparecchiature deve essere evitato poiché potrebbe risultare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questa apparecchiatura e le altre apparecchiature devono essere controllate per verificare che funzionino normalmente.
- L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questa apparecchiatura potrebbero causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e provocare un funzionamento improprio.
- Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (compresa le periferiche come i cavi d'antenna e le antenne esterne) non devono essere utilizzate a meno di 30 cm (12 pollici) da qualsiasi elemento di KLAROTM, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, si potrebbe verificare una degradazione delle prestazioni di questa apparecchiatura.

Guida e dichiarazione del produttore - Emissione elettromagnetica		
KLAROTM è destinato ad essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito e l'acquirente o l'utente deve assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente elettromagnetico:		
Test di emissione	Conformità	Ambiente elettromagnetico
Emissione RF CISPR 11	Gruppo 1	KLAROTM utilizza l'energia RF solo per la sua funzione interna. In conseguenza le sue emissioni RF sono limitate e ci sono scarse possibilità di produrre interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine.
Emissione RF CISPR 11	Classe A	KLAROTM è adatto per l'uso in strutture sanitarie professionali.
Distorsione armonica IEC 61000-3-2	N/A	
Fluttuazioni di tensione e sfarfallamento IEC 61000-3-3	N/A	

Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica			
KLAROTM è destinato ad essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito e l'acquirente o l'utente deve assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente elettromagnetico:			
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Disturbi di conduzione indotti da campi RF IEC 61000-4-6	3V 0.15 MHz~80 MHz 6V nelle bande ISM fra 0.15 MHz e 80 MHz 80% AM al 1kHz	N/A	N/A
Campi RF EM irradiati IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz~2.7 GHz 80% AM al 1kHz	3 V/m 80 MHz~2.7 GHz 80% AM al 1kHz	CISPR11 classe A

Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica			
KLAROTM è destinato ad essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito e l'acquirente o l'utente deve assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente elettromagnetico:			
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Scarica elettrostatica IEC 61000-4-2	±8 kV contatto ±15 kV aria	±8 kV contatto ±15 kV aria	Il pavimento deve essere in legno, cemento o ceramica. Se il pavimento è rivestito con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitori elettrici veloci / bursts IEC 61000-4-4	±2 kV frequenza di ripetizione 100 kHz	N/A	Alimentazione a batteria e senza linea di segnale >3m
Sovratensioni IEC 61000-4-5	±1 kV da linea a linea ±2 kV da linea a terra	N/A	Alimentazione a batteria e senza linea di segnale >30m o uscire all'aperto
Cadute di tensione IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 ciclo Al 0°, 45°, 90°, 135°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°. 70% UT; 25 cicli al 0°	N/A	Alimentazione a batteria
Interruzioni di tensione IEC 61000-4-11	0% UT; 250 ciclo		
Campo magnetico a potenza alla frequenza nominale IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz	30 A/m 50Hz	Il campo magnetico della potenza alla frequenza di alimentazione deve avere le caratteristiche per l'uso in un luogo tipico di un ambiente commerciale o ospedaliero tipico.
Nota: UT si riferisce alla tensione alternata dell'alimentazione prima dell'applicazione della tensione di prova.			

Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica						
KLAROTM è destinato ad essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito e l'acquirente o l'utente deve assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente elettromagnetico:						
Immunità alle apparecchiature di comunicazione senza fili RF (IEC 61000-4-3)						
Frequenza di prova (MHz)	Banda (MHz)	Servizio	Modulazione	Potenza massima (W)	Distanza (m)	Livello di prova dell'immunità (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Modulazione d'impulso 18 Hz	1.8	0.3	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5kHz deviazione 1kHz seno	2	0.3	28
710	704 - 787	LTE Banda 13, 17	Modulazione d'impulso 217Hz	0.2	0.3	9
745						
780						

810	800 —	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Banda 5	Modulazione d'impulso 18Hz	2	0.3	28
870	960					
930						
1720		GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Banda 1, 3, 4, 25, UMTS	Modulazione d'impulso 217Hz	2	0.3	28
1845	1700 — 1990					
1970						
2450	2400 — 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Banda 7	Modulazione d'impulso 217Hz	2	0.3	28
5240						
5500	5100 — 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulazione d'impulso 217Hz	0.2	0.3	9
5785						

Glossario dei Simboli

	Consultare le istruzioni per l'uso		Da utilizzare entro il (AAAA-MM)
	Numero di catalogo		Protezione dell'ingresso
	Numero di lotto		Temperatura ammissibile
	Non riutilizzare		Umidità relativa accettabile
	Metodo di sterilizzazione con OE		Produttore del dispositivo
	Il contenuto è sterile, a meno che la confezione interna non sia stata aperta o danneggiata		Rappresentante autorizzato CE
	Mantenere asciutto		Attenzione
	Tipo BF parte applicata (barra luminosa)		